

Umgang mit Schnittstellen in der AEMP

22.ZSVA Hygiene-Forum

29.10.2022

Damp



center of excellence
Zentrum für Herz- und Gefäßkrankheiten, Kardiologie
Herzchirurgie, Anästhesiologie und Rehabilitation

Carola Abrahamson

Schüchtermann-Klinik
49214 Bad Rothenfelde

OP- Management


Ltg AEMP

Ltg Chirurgie-Assistenten

Ltg OP Pflege

Ltg Facilitymanagement OP


Schüchtermann-Klinik

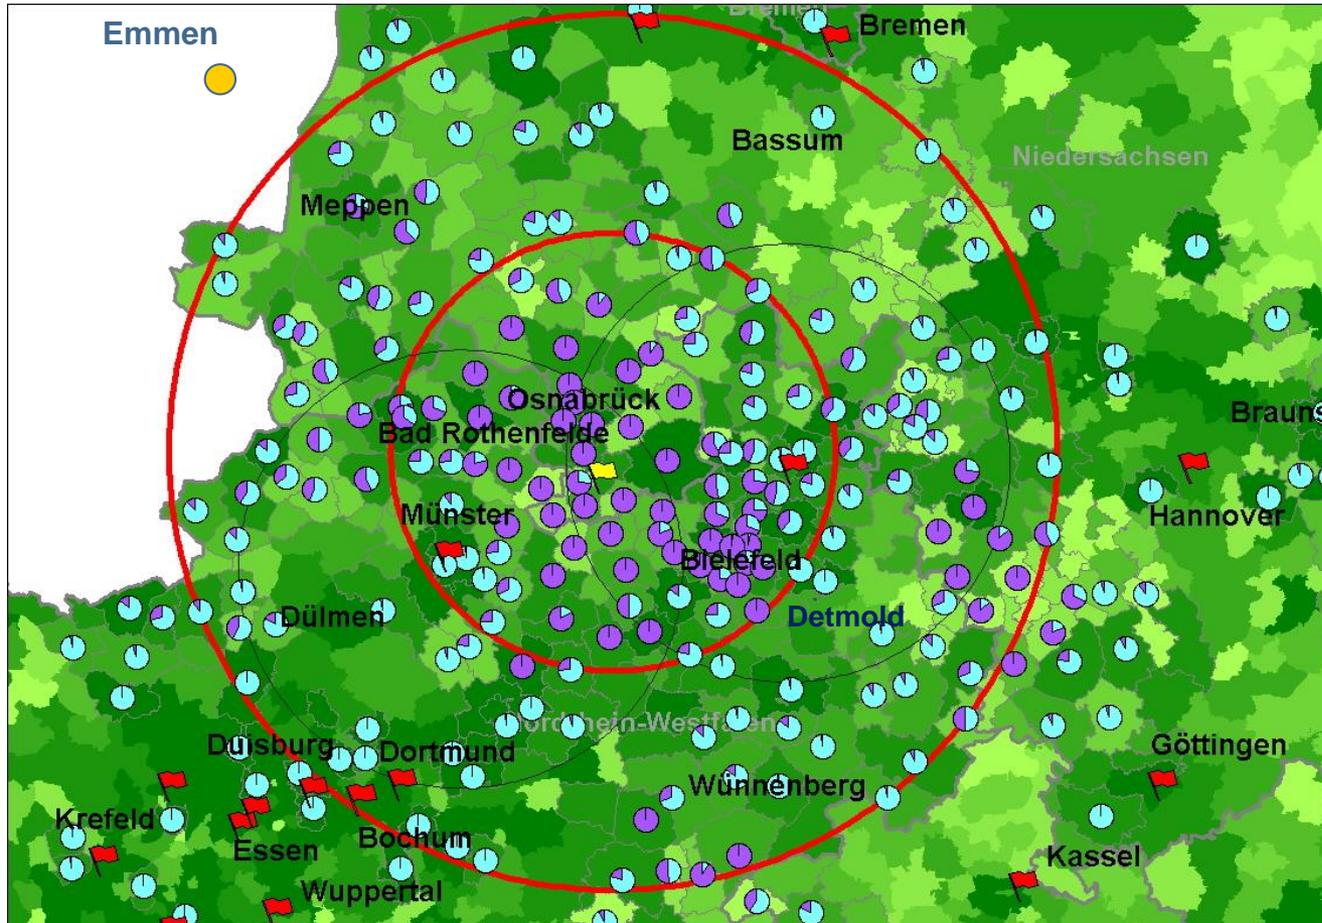

Versorgung von ca. 2,5 Mio. Einwohnern

3000 HLM - Operationen / Jahr

Wo sind wir

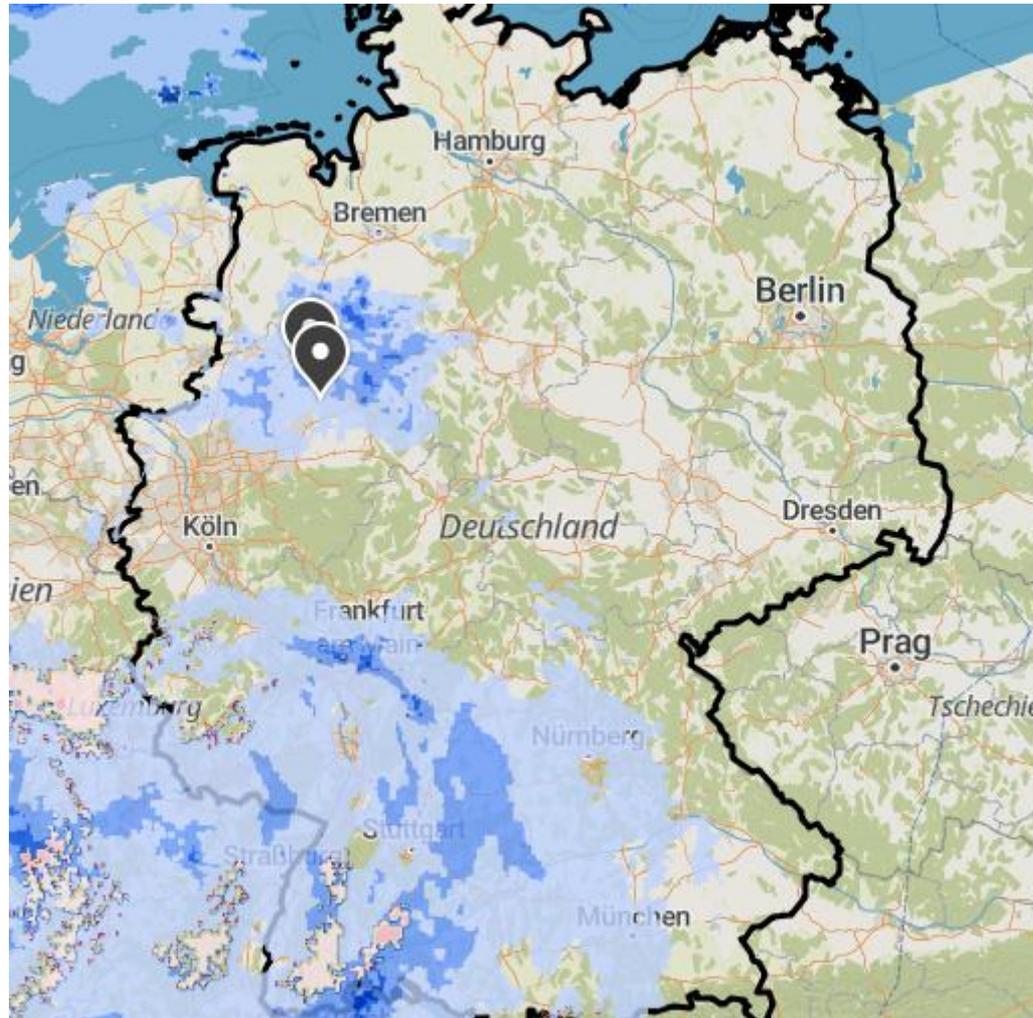

Schüchtermann-Klinik



Schüchtermann-Klinik

Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde / Niedersachsen




Integriertes Herzzentrum

- Kardiologie
- Herzchirurgie
- Rehabilitation


Werdegang

- 1983 Examen in Berlin
- 1985 Neurochirurgischer OP
- 1986 Allg.-chirurgischer OP
- 1987 Dt. Herzzentrum Berlin
- Seit 1993 in Bad Rothenfelde
- 1995 Ausbildung in Phönix / Arizona zur „first surgical room nurse“
- 2002 Ausbildung zur OP – Managerin
- 1999 - 2019 Fachkunde I-III
- Seit 2003 Ausbildung in Fach- und Sachkunde
- 2015 Fachfrau für Hygiene und Gebäudetechnik

Bauliche Gegebenheiten

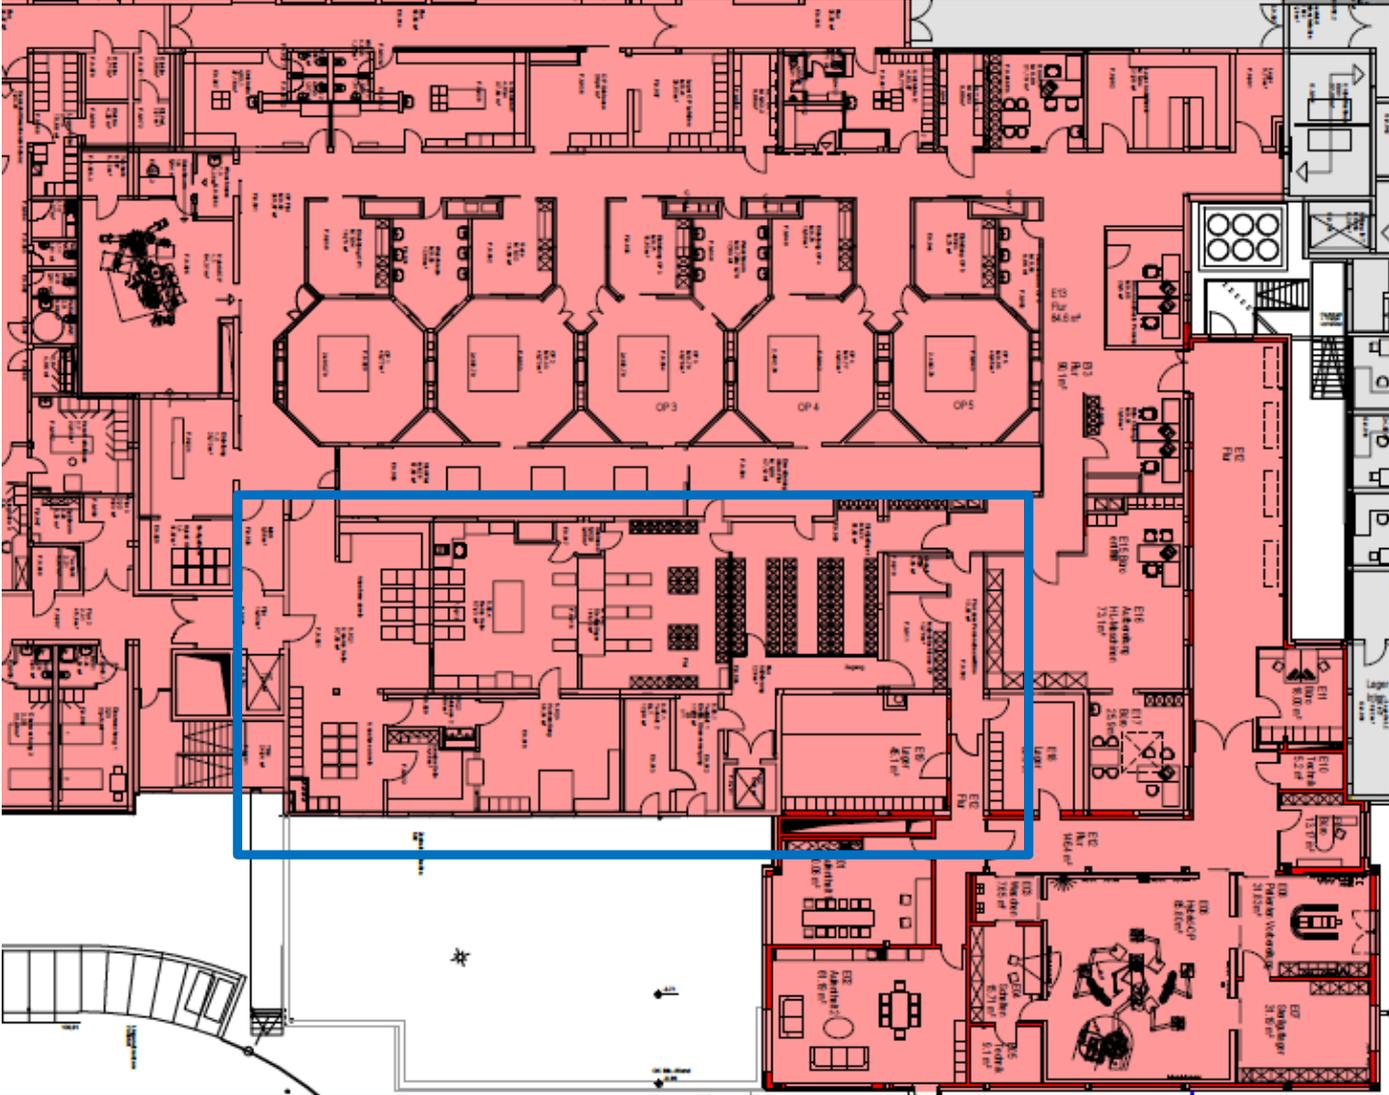

Hierarchie

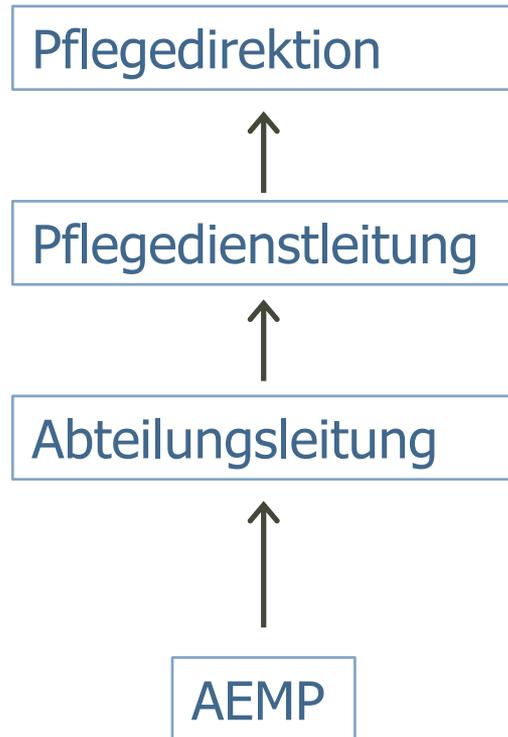


Welche Abteilungen betrifft das ?

- OP / Stationen / Funktionsdienst
- Haustechnik
- Medizintechnik
- Einkauf
- IT
- Personalstelle
- QM
- Controlling



Schnittstelle Haustechnik

- Haustechnik
- Erschwerend da Männer dominiert
- Aufgaben verteilen, aber wie?

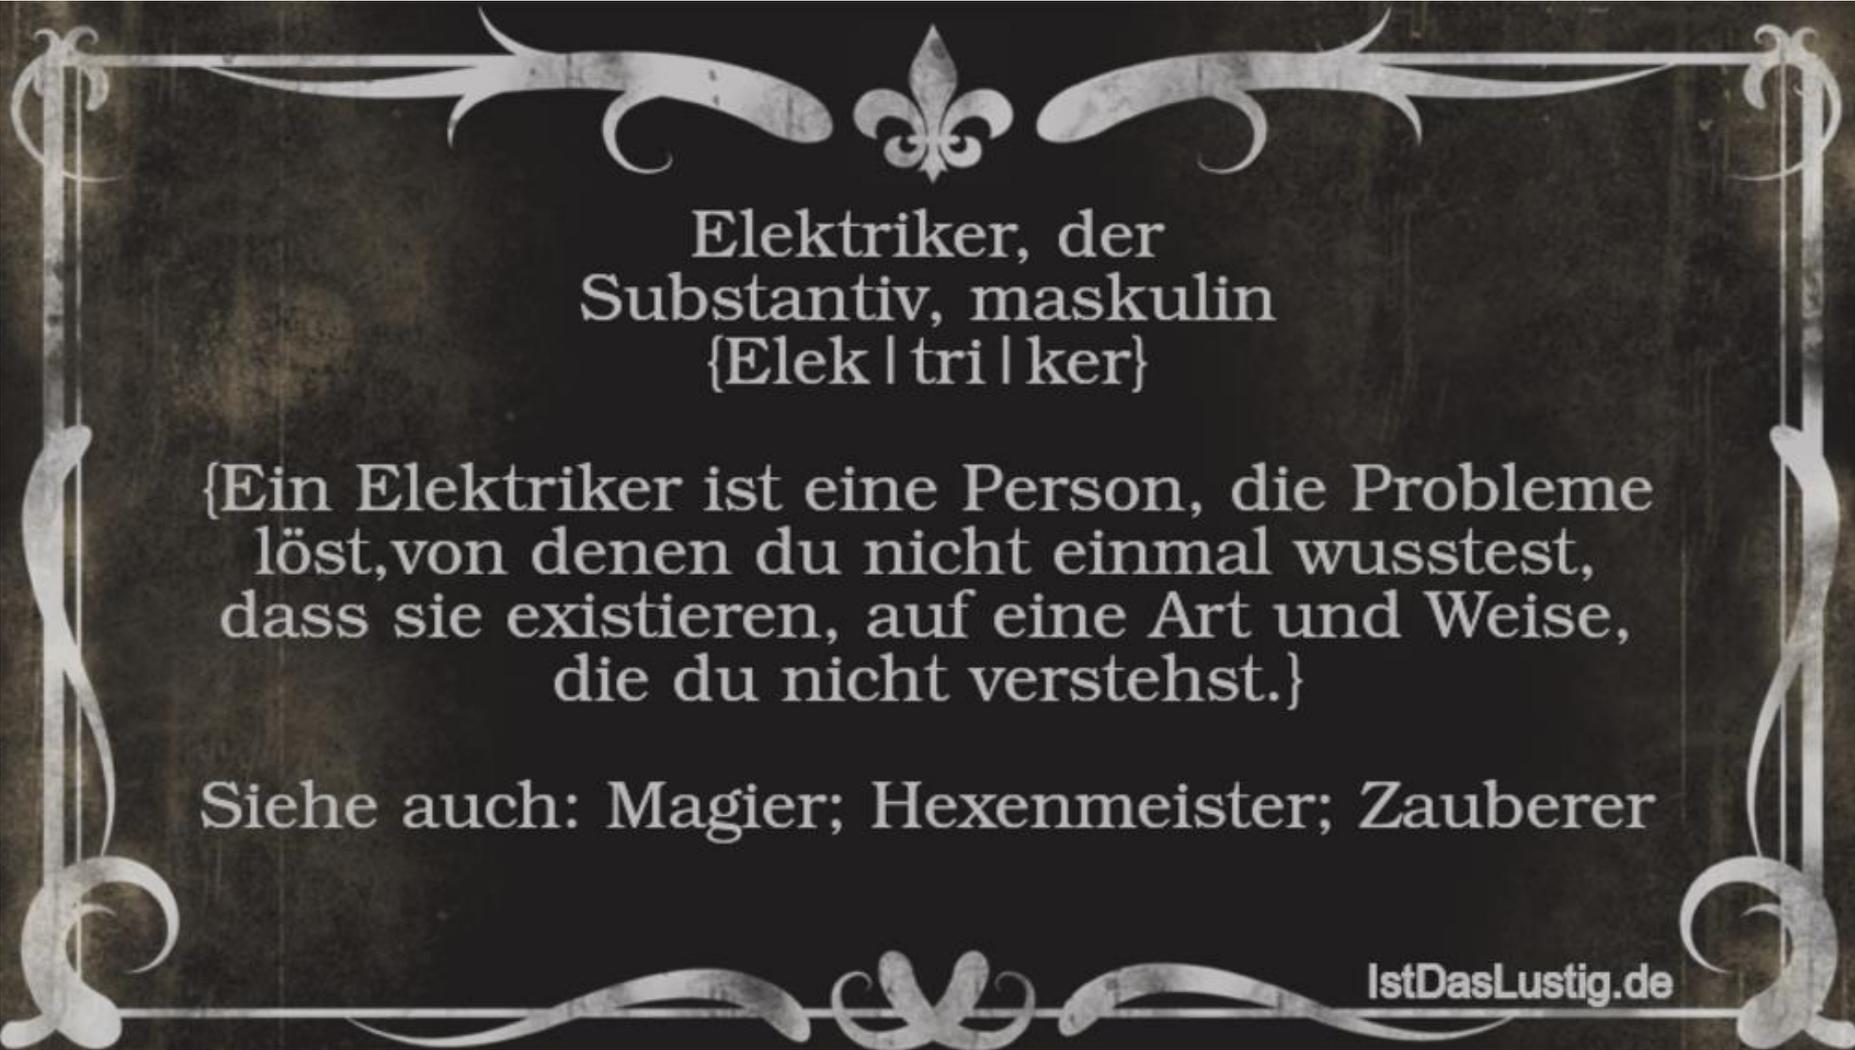

Elektriker, der
Substantiv, maskulin
{Elek | tri | ker}

{Ein Elektriker ist eine Person, die Probleme löst, von denen du nicht einmal wusstest, dass sie existieren, auf eine Art und Weise, die du nicht verstehst.}

Siehe auch: Magier; Hexenmeister; Zauberer

IstDasLustig.de

Schnittstelle Einkauf

- Nur bedingtes Wissen vorhanden
 - AEMP bei Kaufentscheidungen dabei
 - Schein !!

Checkliste

für hausrelevante Daten vor Neukauf von
Medizinprodukten in der Schüchtermann-Klinik

Die Einkaufsliste dient der Entscheidungsfindung durch die Abteilungen Einkauf & Logistik / Medizintechnik zusammen mit den Hygienefachkräften, den Hygienebeauftragten Ärzten und der Hygieneverantwortlichen der AEMP.

Produktbezeichnung: _____	Herstelleranschrift: _____
Artikelnummer: _____	Medizinproduktehersteller: _____
Ggf. Seriennummer: _____	Telefonnummer: _____
	Faxnummer: _____

Erforderliche Angaben	In Anlage	
	vorhanden	Nicht notwendig
Konformitätenerklärung/ Zertifikat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufbereitungsanleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienungsanleitung bzw. Produktbeschreibung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Validierungs- bzw. Testbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artikelliste für Zubehör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulungsmaterial (mögl. CD-ROM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturreferenzliste (mindestens 3 Möglichkeiten zur Auswahl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erforderliche Angaben	Beschreibung in Aufbereitungsanleitung vorhanden	
	Ja	Nein
Demontage bzw. Montage zur Aufbereitung notwendig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wartung bzw. regelmäßige Prüfungen notwendig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschränkung der Anzahl der Aufbereitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keine Aufbereitung durch Hersteller vorgesehen (Einmalartikel) → Eingabe in Deutsches MedizinprodukteInformations- und Datenbanksystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maschinelle Reinigung – thermische Desinfektion bei 93°C möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maschinelle Reinigung – chemisch-thermische Desinfektion möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manuelle Reinigung notwendig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tauchdesinfektion möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wischdesinfektion notwendig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ultraschallaufbereitung möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einsatz alkalischer Reinigung möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erforderliche Freigabe folgender Desinfektionsmittel:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Incidin® plus		
• Incidin® Active		
• Sekusept® Classic		
• Sekusept® Active		
• Mikrozid® universal wipes		
Ausschluss bestimmter Chemikalien (z.B. Weichmacher) notwendig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GM-06-A002
Stand: 29.11.2018

Aktuelle Fassung im Intranet - Papierdrucke dienen nur der Information

Checkliste

für hausrelevante Daten vor Neukauf von
Medizinprodukten in der Schüchtermann-Klinik

Erforderliche Angaben	Beschreibung in Aufbereitungsanleitung vorhanden	
	Ja	Nein
Lagerungshilfen für Aufbereitung und Transport notwendig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Besondere Anforderung an die Verpackung des MP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pflegemittel notwendig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
autoklavierbar bei 134 °C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
autoklavierbar bei 121 °C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formaldehydsterilisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plasmasterilisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparatursatzgestellung möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Probegestellung möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Firmenstempel

Datum

Unterschrift

GM-06-A002
Stand: 29.11.2018

Aktuelle Fassung im Intranet - Papierdrucke dienen nur der Information

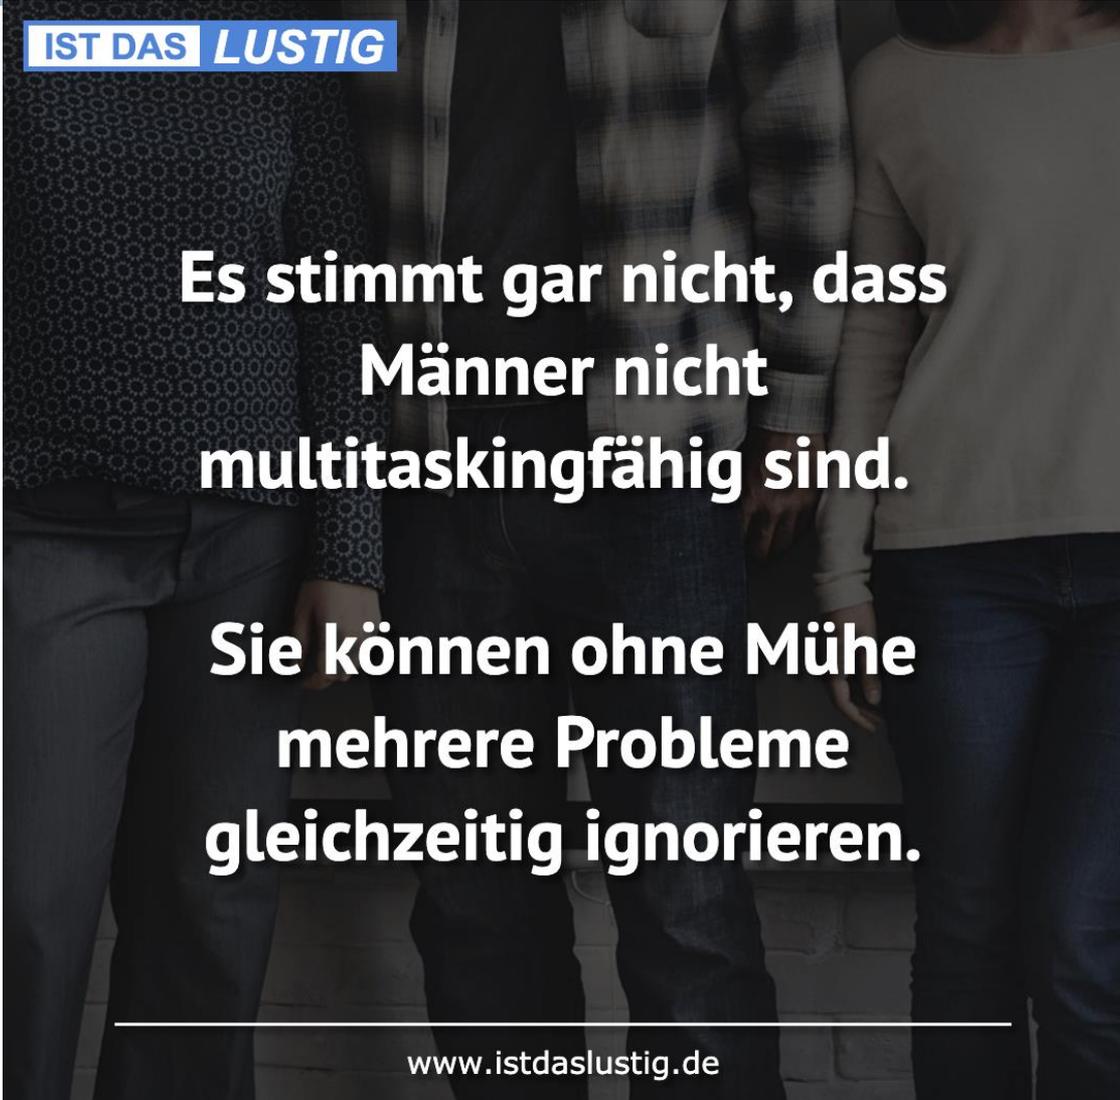

IST DAS LUSTIG

**Es stimmt gar nicht, dass
Männer nicht
multitaskingfähig sind.**

**Sie können ohne Mühe
mehrere Probleme
gleichzeitig ignorieren.**

www.istdaslustig.de

Schnittstelle QM

Durch das QM viele Dinge leichter

- Schnittstellen Probleme
- Interne / Externe Kommunikation


Schnittstelle Personalwesen

- Berechnungen PS
- EV was ist das ?
- Abrechnungen

Schnittstelle Personalwesen

- Berechnungen PS
- EV was ist das ?
- Abrechnungen

Wie löse ich ein Problem ?

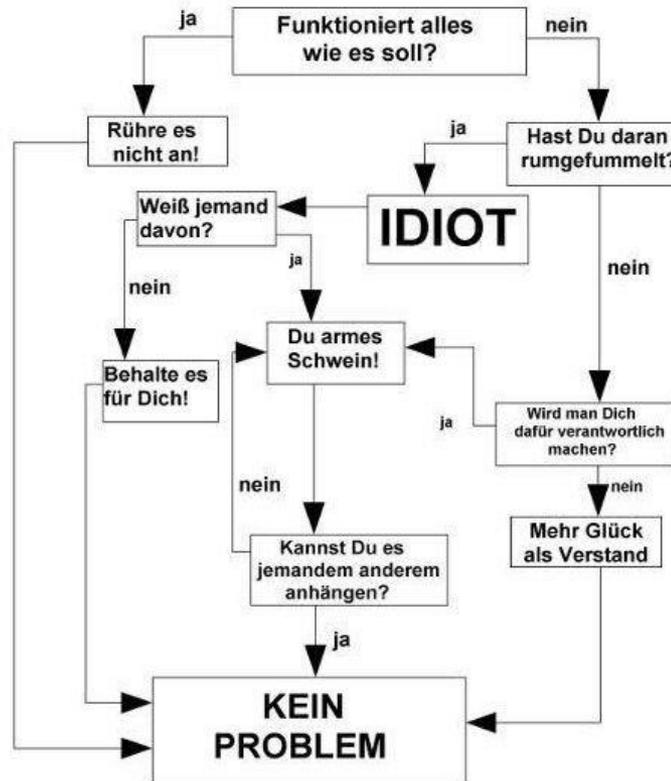

Schnittstelle IT

1. Sieb
Chargen.-Nr. Memo
Bemerkungen

2. Sieb
Chargen.-Nr.
Bemerkungen

3. Sieb
Chargen.-Nr.
Bemerkungen

4. Sieb
Chargen.-Nr.
Bemerkungen

5. Sieb
Chargen.-Nr.
Bemerkungen

6. Sieb
Chargen.-Nr.
Bemerkungen

7. Sieb
Chargen.-Nr.
Bemerkungen

8. Sieb
Chargen.-Nr.
Bemerkungen

9. Sieb
Chargen.-Nr. Memo
Bemerkungen

VERFÜGBARE SIEBE

Sortierung: Filter:

CODE	BEZEICH	BQS_2020	DEFI5
9	OP defekt an Verpackung		
6	OP falsche Montage		
5	OP Instrument deformiert		
7	OP Instrument fehlt		
8	OP Instrument zu viel im Set		
2	OP Korrosionsschaden		
1	OP Maul/Backen defekt		
3	OP Restverschmutzung		
4	OP Schneidfläche defekt/stumpf		
10	OP sonstige Memo		
48	ZSVA falsche Entsorgung		
43	ZSVA fehlende Demontage		
44	ZSVA Instrument deformiert		
45	ZSVA Instrument fehlt		
46	ZSVA Instrument Korrosion		
41	ZSVA scharfe/spitze Gegenstände im Sieb		
47	ZSVA Schneidfläche defekt/ Stumpf		
42	ZSVA Siebschale überladen		
50	ZSVA sonstige Memo		

**„Wie viele Menschen arbeiten
in deinem Unternehmen?“**

„Ich schätze,
knapp ein Drittel.“

Schnittstelle Medizintechnik

- Medizintechnik
- Wer macht was ?
- Ist das geregelt, oder ?
- Wer nett ist muss arbeiten ?



Schnittstelle Controlling

- Nutzung für Außendarstellung





-
- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!